



## (주) 중앙 감정평가법인

수 신 대한적십자사 서울적십자병원장  
참 조 대한적십자사 서울적십자병원 구매시설부  
제 목 감정의뢰에 대한 회신

---

1. 항상 우리 감정평가업무에 협조하여 주심에 대하여 깊이 감사드리며,  
귀 서울적십자병원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2023.11.01일자 귀 제 『 -- 』로 의뢰하신 『 서울특별시 종로구 평동  
164 (새문안로 9) 서울적십자병원 소재 기계기구 및 동산 감정평가 』에 대하여 붙임과  
같이 감정하여 회보합니다.

3. 우리 법인은 부가가치세법 제32조 제2항(법인의 전자세금계산서  
의무발행)에 의거 전자세금계산서를 발행하오니 필요사항(사업자등록증 사본, 담당자명,  
유·무선 전화번호, 이메일)을 기재하여 팩스나 이메일로 회신하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1) 감정평가서                    1부  
          2) 청구서                        1부    끝.

## 대 표 이 사

---

담당부서 : 감정팀

담당평가사 : 엄덕재

시행 중앙 012023-1101-002 (2023.11.14)

우06651 서울시 서초구 서초중앙로 63 2F (서초동, 리더스빌딩)

TEL. 02-598-9500 FAX. 02-598-9600 / <http://www.jaa.co.kr>

## 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

### II. 대상 물건의 개황

#### 1. 대상 물건의 개요

기호	장비명	모델명	수량	취득일자	장비상태	비고
(1)	IV POLE SET	-	8대	2014-08-18	노후, 수리불가	동산
(2)	심전도기	AT-102(SCM)	1대	2016-07-27	노후, 측정오류	기계기구
(3)	심전도기	AT-102(SCM)	1대	2016-07-27	노후, 측정오류	기계기구
(4)	ALTOSHOOTER	H157*L90*W48M/M	1대	1999-09-29	노후	기계기구
(5)	에센스네블라이저	-	3대	2015-11-19	노후, 부품단종	기계기구
(6)	24시간 혈압측정기	TM-2430	1대	2012-01-20	노후	기계기구
(7)	인공호흡기(고)	MV2000-10G-0119	1대	2008-10-15	노후	기계기구
(8)	F.E.S(기능적전기자극치료기)	-	1대	2005-10-18	노후	기계기구
(9)	인공호흡기(고)	BP-840	1대	2008-01-28	노후, 고장	기계기구
(10)	인공호흡기(고)	BP-840	1대	2008-08-21	노후, 고장	기계기구
(11)	인공호흡기(고)	BP-840	1대	2009-11-04	노후, 고장	기계기구
(12)	메디케이션카트	SMC-N500	1대	2012-12-31	노후	동산
(13)	MICROSCOPE (현미경)	NO24600	1대	1989-06-16	노후	기계기구
(14)	BILIRUBINO METER (빌리루빈 미터기)	NEB-BILPULS	1대	2010-07-21	노후, 수리불가	기계기구
(15)	MICROSCOPE (현미경)	245854	1대	1991-10-24	노후	기계기구
(16)	MICROSCOPE (현미경)	NO221911	1대	1991-08-03	노후	기계기구
(17)	프로젝트 빔	-	1대	2009-03-17	노후	기계기구
(18)	Infusion pump	DI-2000, DI-2200	각1대	-	고장, 수리불가	기계기구
(19)	PATIENT MONITORING (환자감시장치)	DS-7100	2대	2006-09-28	노후, 수리불가	기계기구
(20)	환자 CAST CUTTER	-	1대	1996-04-30	노후, 사용불가	기계기구
(21)	스마트 모금함	bm-s4031k	1대	2013-12-31	고장, 사용불가	기계기구
(22)	인덕션낮은렌지	instem	2대	2014-04-30	노후	기계기구
(23)	안압측정기	TX-F	1대	2003-11-14	노후	기계기구

## 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

기호	장비명	모델명	수량	취득일자	장비상태	비고
(24)	폐기능검사기	HI-801	1대	2006-11-29	노후	기계기구
(25)	무산동안저카메라(안저촬영기)	AFC-330	1대	2014-08-18	노후	기계기구
(26)	내시경	0도	1대	1994-11-23	노후, 수리불가	기계기구
(27)	프린터기	HP Laserjet ProM12a	1대	2018-04-09	고장	기계기구
(28)	가스부침기	-	1대	2010-10-06	노후	기계기구
(29)	내시경 Telescope	0도	1대	1993-11-23	노후, 수리불가	기계기구

※ 출처 : 귀 제시목록

## 2. 대상물건의 현황

본건 기호(1)~(29)는 서울특별시 종로구 평동 소재하는 '대한적십자사 서울적십자병원'에서 보유하고 있는 의료 기구 및 장비(불용품)로서 대체로 노후화 되었음.

## 감정평가액의 산출근거 및 결정 의견

### 3. 대상물건의 보관장소

기호	소재지	소재 층수 및 실명	비고
(8)	서울특별시 종로구 평동 164 서울적십자병원 내	지하1층 물리치료실	-
(20)		지하1층 물품관리실	-
(7)		1층 응급실	-
(17)		1층 직물관리실	-
(22)		1층 창고	-
(27)		1층 영양실	-
(23),(24),(25)		2층 건강검진실	-
(26),(29)		2층 이비인후과 진료실	-
(28)		2층 옥외	-
(4)		3층 내시경실	-
(6)		3층 심장검사실	-
(13),(14),(15),(16)		3층 진단검사의학과 창고	-
(21)		4층 탕비실	-
(5),(9),(10),(11),(12),(18),(19)		5층 중환자실	-
(2)		6층 창고	-
(3)		7층 716호	-
(1)		10층 1008호	-

※후첨 기계기구 및 동산 배치도 참고

### 4. 기타 참고사항

없음.

## (기계기구 및 동산) 감정평가명세서

기호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제작자 제작일자	수량	감정평가액		비 고
				단 가	금 액	
1	IV POLE SET  Model: -	(미상) 제작일:미상 S/N: 미상 구매일:2014.08.18	8대			해체처분 가액 10층 1008호
2	심전도기  Model: CARDIOVIT AT-102 품목허가번호: 수허 08-183호 전기적 정격:110/220VAC, 50/60Hz, 28VA	Schiller AG (스위스) 제작일:2016.06.24 S/N:070.11774 구매일:2016.07.27	1대			해체처분 가액 6층 참고
3	심전도기  Model: CARDIOVIT AT-102 품목허가번호: 수허 08-183호 전기적 정격:110/220VAC, 50/60Hz, 28VA	Schiller AG (스위스) 제작일:2016.06.24 S/N:070.11760 구매일:2016.07.27	1대			해체처분 가액 7층 716호
4	ALTO SHOOTER  Model: - 승인번호: (06B) 제0288호 전원: 단 3건전지 x 4개	아사히 전자공업주식회사 (일본) 제작일: 미상 S/N: 01315 구매일:1999.09.29	1대			해체처분 가액 3층 내시경실
5	에센스네블라이저  Model: InnoSpire Essence 품목허가번호: 수허 14-1498호 중량: 1.5kg 220V~60Hz 1.2A	Providence Enterprise Ltd (중국) 제작일: 미상 S/N: 1052007260 S/N: 1052007259 S/N: 1052007257 구매일:2015.11.19	3대			해체처분 가액 5층 중환자실
6	24시간 혈압측정기  Model: AND TM-2430 72(W) x 100(D) x 27(H) mm	Kensei Industry Co. Ltd (일본) 제작일: 미상 S/N: 미상 구매일:2012.01.20	1대			2,181,818 x0.030(0/10) 3층 심장검사실

# (기계기구 및 동산) 감정평가명세서

기호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제작자 제작일자	수량	감정평가액		비 고
				단 가	금 액	
7	인공호흡기 (고)  Model: MV2000-10G-0119 품목허가번호: 제허06-811호 중량: 약35kg(본체에만 적용) 100-120V~, 10A, 50/60Hz 200-240V~, 5A, 50/60Hz	주식회사 맥아이씨에스 제작일: 미상 S/N: 10.07 구매일:2008.10.15	1대			25,000,000 x0.030(0/10) 1층 응급실
8	F.E.S (기능적전기자극치료기)  Model: microstim 전원공급장치: Varta TR7/8 배터리2개	Medel GmbH (독일) 제작일: 미상 S/N: 11072 구매일: 2005.10.18	1대			해체처분 가액 지하1층 물리 치료실
9	인공호흡기 (고)  Model: 840 Vent New Zealand/China 품목허가번호: 제 수허07-532호 정격전압: 200-240VAC/1.5A 소비전력: 330~360VA, 902~943VA 주파수: 50~60Hz 802백업전원공급기 : 24V dc, 6.5Ah	Nellcor Puritan Bennett (아일랜드) 제작일: 미상 S/N: 07 170 95178 구매일: 2008.01.28	1대			해체처분 가액 5층 중환자실
10	인공호흡기 (고)  Model: 840 Vent New Zealand/China 품목허가번호: 제 수허07-532호 정격전압: 200-240VAC/1.5A 소비전력: 330~360VA, 902~943VA 주파수: 50~60Hz 802백업전원공급기 : 24V dc, 6.5Ah	Nellcor Puritan Bennett (아일랜드) 제작일: 미상 S/N: 08 170 92958 구매일: 2008.08.21	1대			해체처분 가액 5층 중환자실

(기계기구 및 동산) 감정평가명세서

기호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제작자 제작일자	수량	감정평가액		비 고
				단 가	금 액	
11	인공호흡기 (고)  Model: 840 Vent New Zealand/China 품목허가번호: 제 수허07-532호 정격전압: 200-240VAC/1.5A 소비전력: 330~360VA, 902~943VA 주파수: 50~60Hz 802백업전원공급기 : 24V dc, 6.5Ah	Nellcor Puritan Bennett (아일랜드) 제작일: 미상 S/N: 09 170 94434 구매일: 2009.11.04	1대			해체처분 가액 5층 중환자실
12	메디케이션카트  Model: SMC-N500	(미상) 제작일:미상 S/N: 미상 구매일:2012.12.31	1대			해체처분 가액 5층 중환자실
13	MICROSCOPE(현미경)  Model: BHT	OLYMPUS (일본) 제작일:미상 S/N: 243600 구매일:1989.06.16	1대			해체처분 가액 3층 진단검사 의학과 참고
14	BILIRUBINO METER (빌리루빈 미터기)  Model: NEO BIL PLUS 경격: 115-230V, 50-60Hz 출력: 25W 중량: 2.7kg 품목허가번호: 서울수신 06-939호	Digital and Analog Syetem (이탈리아) 제작일: 2007.07.10 S/N:미상 구매일:2010.07.21	1대			해체처분 가액 3층 진단검사 의학과 참고
15	MICROSCOPE(현미경)  Model: BHT	OLYMPUS (일본) 제작일:미상 S/N: 245854 구매일:1991.10.24	1대			해체처분 가액 3층 진단검사 의학과 참고

**(기계기구 및 동산) 감정평가명세서**

기호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제작자 제작일자	수량	감정평가액		비 고
				단 가	금 액	
16	MICROSCOPE(현미경)  Model: -	OLYMPUS (일본) 제작일:미상 S/N: 800259 구매일:1991.08.03	1대			해체처분 가액 3층 진단검사 의학과 참고
17	프로젝트 빔  Model: BG650-JL.AKRLLA 신고번호: ZL10001-14001 KCC-RMM-LGE-BG630	(주)새로닉스 제작일: 2014.06.23 S/N: 4068RZ87W733 구매일:2009.03.17	1대			1,250,000 x0.030(0/10) 1층 직물관리실
18	Infusion Pump  1) DI-2000  중량: 1.7kg 경격: 100-240V~, 50/60Hz, 12V 소비전력: 35VA 전기충격에서의 보호: 1급기기, CF형 제조품목 허가번호: 제10-170호	대화기기(주) 제작일: 2011.11.07 S/N: DI20KOR1111179 구매일:미상	1대			해체처분 가액 5층 중환자실
	2) DI-2200	대화기기(주) 제작일: 미상 S/N: 미상 구매일: 미상	1대			해체처분 가액 5층 중환자실
19	PATIENT MONITORING (환자감시장치)  Model: DS-7100 VOLTAGE: AC100-240V 50/60Hz 82VA EQUIPMENT TYPE: CLASS I 품목허가번호 : 제 수허 03-1088호 중량 5.1kg	FUKUDA DENSHI CO. LTD 제작일:미상 S/N: 38111821 S/N: 37141549 구매일:2006.09.28	2대			해체처분 가액 5층 중환자실

## (기계기구 및 동산) 감정평가명세서

기호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제작자 제작일자	수량	감정평가액		비 고
				단 가	금 액	
20	환자 CAST CUTTER  Model: 986 CastVac with Mobile Stand 100-120V ~ 50-60Hz 8.5A Duty Cycle: Continuous	STRYKER (USA) 제작일:미상 S/N: 95120123 구매일:1996.04.30	1대			해체처분 가액 지하1층 물품 관리실
21	스마트모금함  Model: BM-S4031K	(주)엘트브 제작일: 2013.06 S/N: BM40K13F051 구매일: 2013.12.31	1대			해체처분 가액 4층 탕비실
22	인덕션낮은렌지  Model: 미상	Instem 제작일: 미상 S/N: 미상 구매일: 2014.04.30	2대			해체처분 가액 1층 창고
23	안압측정기  Model: TX-F 경격: AC220/240V 50/60HZ 96VA 전기충격에서의 보호: 1급 B형기기 중량: 20.5KGS	CANON INC. (일본) 제작일: 2003.09.19 S/N: 100436 구매일: 2003.11.14	1대			해체처분 가액 2층 건강검진실
24	폐기능검사기  Model: Multi-functional Spirometer HI-801 200-230V~, 50/60Hz, 70VA CLASS II TYPE BF	CHEST M.I. INC. (일본) 제작일: 2006.10 S/N: 14810167 구매일: 2006.11.29	1대			해체처분 가액 2층 건강검진실
25	무산동안저카메라(안저촬영기)  Model: AFC-330 100-240V~ 50/60Hz 150VA	NIDEK CO., LTD. (일본) 제작일: 2014 S/N: 320559 구매일: 2014.08.18	1대			31,363,636 x0.043(1/10) 2층 건강검진실

## (기계기구 및 동산) 감정평가명세서

기호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제작자 제작일자	수량	감정평가액		비 고
				단 가	금 액	
26	내시경  Model: HENKE-SASS, WOLF 0 <sup>o</sup>	mega (독일) 제작일: 미정 S/N: 400585 구매일: 1994.11.23	1대			해체처분 가액 2층 이비인후과 진료실
27	프린터기  Model: HP Laserjet Pro M12a 220-240C ~AC 50/60Hz, 2.3A	캐논 베트남 (베트남) 제작일: 2017.07 S/N: VNCX808553 구매일: 2018.04.09	1대			해체처분 가액 1층 영양실
28	가스부침기  Model: - 1200 x 750 x 800	(미상) 제작일:미상 S/N: 미상 구매일: 2010.10.06	1대			해체처분 가액 2층 옥외
29	내시경 Telescope  Model: HENKE-SASS, WOLF 0 <sup>o</sup>	mega (독일) 제작일: 미정 S/N: 400613 구매일: 1993.11.23	1대			해체처분 가액 2층 이비인후과 진료실
- 합 계 -					-이 하 여 백-	


## (기계기구 및 동산) 감정평가명세서

기호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제작자 제작일자	수량	감정평가액		비 고
				단 가	금 액	
	Model: 3700 Pulse Oximeter 50/60Hz 30VA Max	(USA) 제작일:미상 S/N: FMAU01296 구매일:1993.02.19				7층 703호
	3) 환자감시장치  Model: Ohmeda Model 4700 OxiCap	OHMEDA BIOX (USA) 제작일:미상 S/N: FMYT00618 구매일:1993.02.19				7층 703호
	Model: SERVOMED CAT NO.: 10104901 SMS 151 220V~ 49..65Hz, 0,13A	HELLIGE (GERMANY) 제작일:미상 S/N: 17476 구매일:1985.11.01				해체처분 가액 7층 703호
	Model: CBR-1000S 중량 : 253Kg 1급기기, B형기기 단상 220V/60Hz 소비전력: 850VA	제작일:2008.09 S/N: GS13080902-361 구매일:2008.09.16	1대			해체처분 가액 지하1층 약품관리실
31	<b>수술실 이비인후과 비내시경 수술장비</b>		1식			해체처분 가액
	1) 칼라 비디오 모니터  Model: CMM-14SM 정격전압전류: AC110-220V, 60Hz/0.8A 정격소비전력: 62W	주식회사 삼양전자 제작일:2002.07 S/N: 11AB700092 구매일:2002.12.12				4층 수술실
	2) 수술장비  Model: NET270	주식회사 삼양전자 제작일:미상 S/N: 미상 구매일:2002.12.12				4층 수술실


## (기계기구 및 동산) 감정평가명세서

기호	명 칭 (종 류) 구조·규격·형식·용량	제작자 제작일자	수량	감정평가액		비 고
				단 가	금 액	
32	수술실 어바인후과 천자,천공기	XOMED (USA) 제작일:미상 S/N: 021726 구매일:1997.10.30	1대			해체처분 가액 4층 수술실
	Model: XPS MicroResector Console REF: 18-95100	(미상) 제작일:미상 S/N: 미상 구매일:2002.11.25				해체처분 가액 7층 703호
	Model: -	STORZ (GERMANY) 제작일:미상 S/N: 06-77582 구매일:1983.01.05	1식			해체처분 가액 7층 703호
	Model: SC-SX19-A1A11	STRYKER ENDOSCOPY (USA) 제작일:미상 S/N: 92110314MC 구매일:1983.01.05				7층 703호
	Model: 782 120VAC 50/60Hz 0.4A	WISAP (GERMANY) 제작일:미상 S/N: 9674724 구매일:1983.01.05				7층 703호
Model: 7070C Voltage: 115V Protect: 1 Current / Class: 0.78A / TYPE B Power inp: 105VA Device Class: GV3 Frequ.: f48762Hz Fuse: 1.0AT	WISAP (GERMANY) 제작일:미상 S/N: 9674718 구매일:1983.01.05				7층 703호	
4) CO2-Aqua-Purator	WISAP (GERMANY) 제작일:미상 S/N: 9674718 구매일:1983.01.05				7층 703호	
Model: 1611						

# 상세위치도



소재지	서울특별시 종로구 평동 164 (새문안로 9) 서울적십자병원 내
-----	-------------------------------------

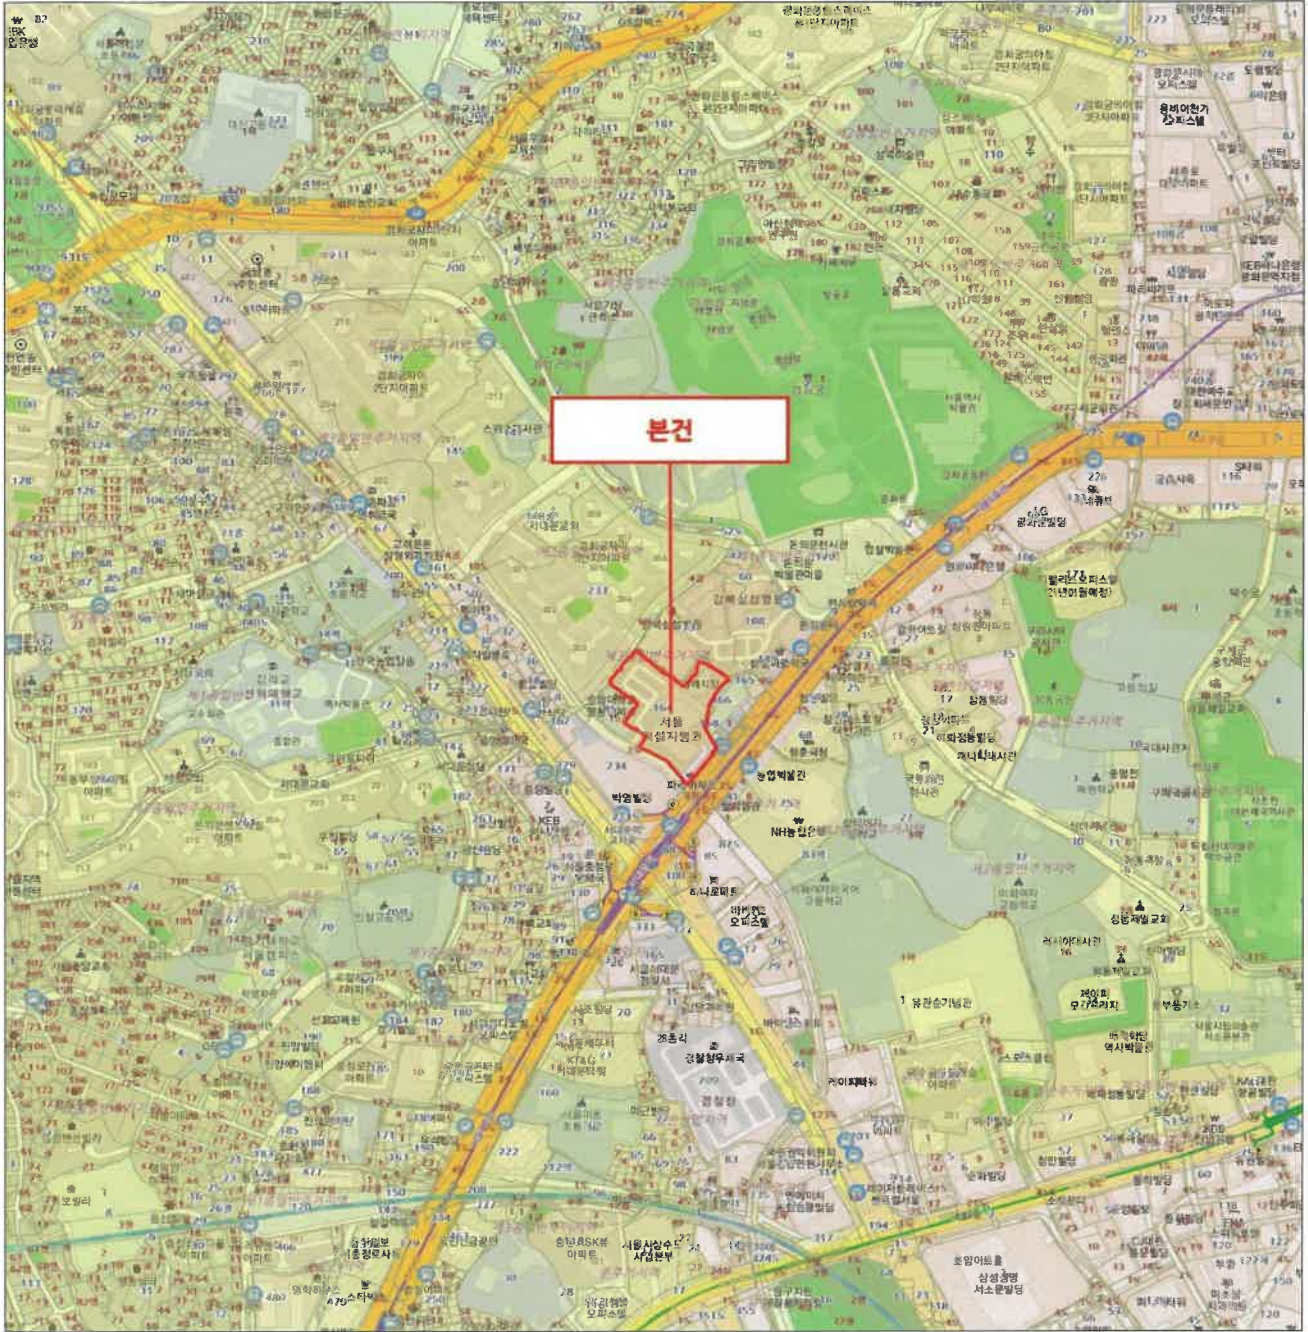

# 사진용지



<기호(1) IV POLE SET>



<기호(2) 심전도기>

# 사진용지



<기호(3) 심전도기>



<기호(4) ALTO SHOOTER>

# 사진용지



<기호(5) 에센스네블라이저>



<기호(6) 24시간 혈압측정기>

# 사진용지



<기호(7) 인공호흡기(고)>



<기호(8) F.E.S(기능적전기자극치료기)>

# 사진용지



<기호(9),(10),(11) 인공호흡기(고)>



<기호(12) 메디케이션카트>

# 사진용지



〈기호(13) MICROSCOPE(현미경)〉




〈기호(14) BILIRUBINO METER(빌리루빈 메터기)〉

# 사진용지



<기호(15) MICROSCOPE(현미경)>

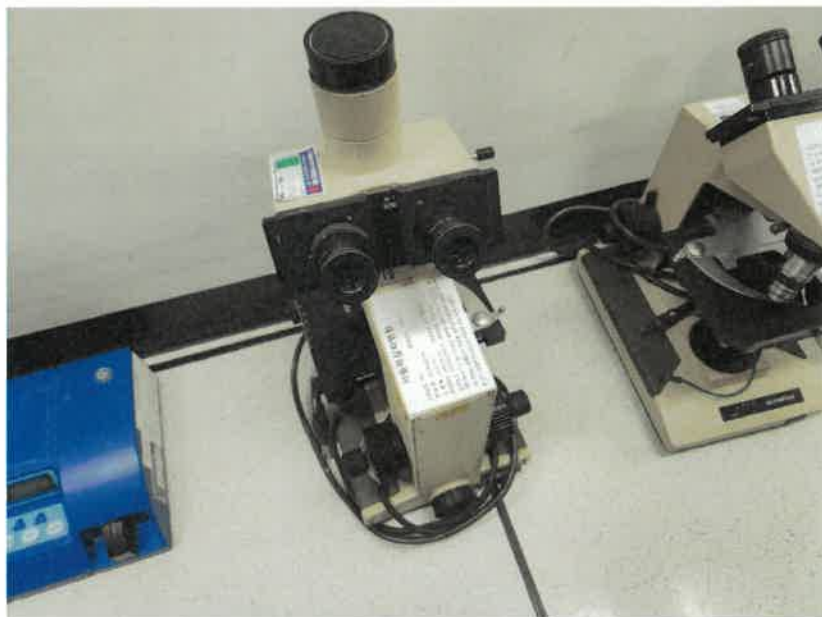

<기호(16) MICROSCOPE(현미경)>

# 사진용지




<기호(17) 프로젝트 빔>



<기호(18) Infusion Pump>

# 사진용지

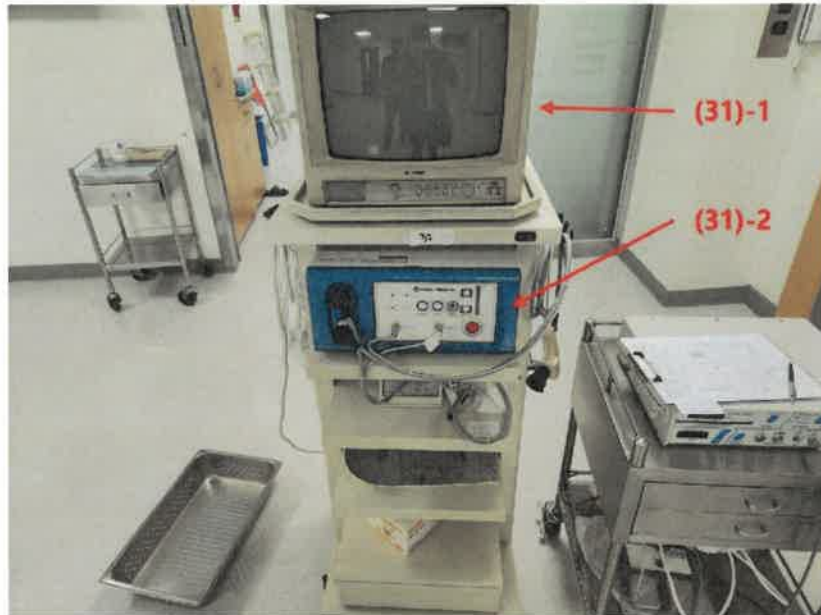

<기호 (31) 이비인후과 비내시경 수술장비>



<기호 (32) 이비인후과 천자,천공기>

# 사진용지



〈기호(19) PATIENT MONITORING (환자감시장치)〉




〈기호(20) 환자 CAST CUTTER〉

# 사진용지



<기호(21) 스마트 모금함>

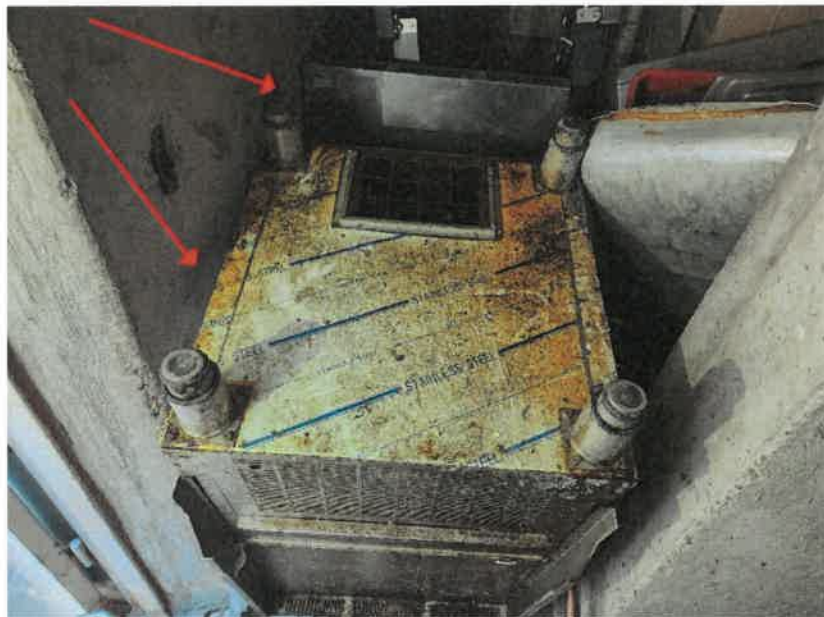

<기호(22) 인덕션낮은렌지>

# 사진용지



<기호(23) 안압측정기>



<기호(24) 폐기능검사기>

# 사진용지



<기호(25) 무산동안저카메라(안저촬영기)>



<기호(26) 내시경>

# 사진용지




<기호(27) 프린터기>



<기호(28) 가스부침기>

# 사진용지

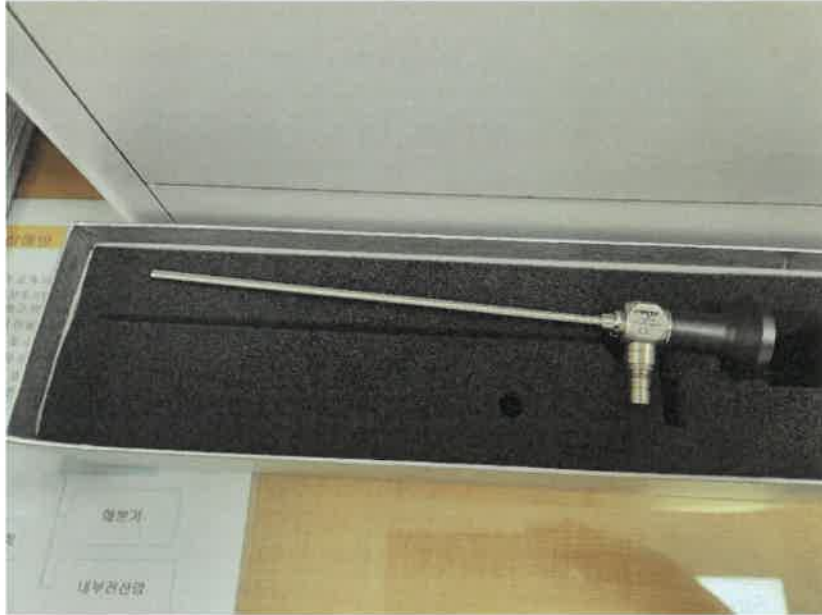

<기호(29) 내시경 Telescope>